

Morrinhos, 01 de abril de 2020

Relatório Técnico

Venho, através deste, apresentar a Defesa Técnica mediante ao Recurso, da Empresa Socram Máquinas e Equipamentos-LTDA, referente aos lotes IV e V do pregão presencial 34/2020 ocorrido no dia 12/03/2020, na sede administrativa do município.


A parte Técnica desqualificou a empresa acima citada, os itens 118.715 e 118.723, pelo fato de que estes itens apresentados por esta Empresa não atenderem o descritivo exposto no Edital, pois no descritivo os Kits teriam que vir Prontos para Uso, ou seja; apresentar somente o Padrão, que em qualquer Kit de qualquer marca tem que ter, e um único Reagente de uso, no entanto conforme as bulas apresentadas pela própria empresa é visto que é preciso usar dois reagentes para realização dos testes.

A Empresa já tinha conhecimento desta descrição PRONTO para USO e bem sabe que esta descrição teria que ter somente um Reagente, mesmo assim, apresentou proposta de Kits não condizentes ao descritivo do Edital, a equipe Técnica não poderia aceitar itens que não estariam de acordo com o descritivo, portanto desqualificou a Empresa em questão.

A equipe Técnica pede Kit prontos para uso porque todas as empresas participantes, que vendem estes tipos de Kits sabem que são Kits monoreagentes, e além disso pedem um só reagente porque o laboratório do município tem somente uma bandeja (carrossel) do aparelho HUMASTAR, para colocar reagentes para realização de exames e se começarmos a usar kits com mais de um reagente lotaria a bandeja (carrossel) , e comprometeria a agilidade de realizar os exames, visto que, este laboratório está dentro de um hospital, e os resultados dos exames tem que serem liberados o mais rápido possível.

Venho ressaltar que a equipe Técnica não tem interesse em desqualificar nenhuma empresa, só não pode aceitar itens que não condizem com o Edital proposto.

Atenciosamente.

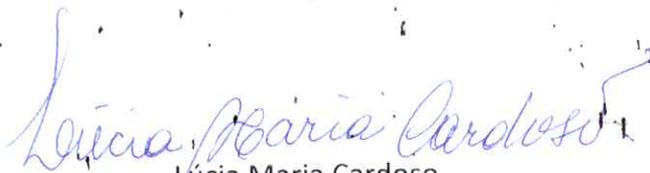

Lúcia Maria Cardoso

Responsável Técnico